

Casete Combo de Prueba Rápida para Dengue (Sangre entera/Suero/Plasma)

Ficha Técnica

REF IDEC-425	Español
--------------	---------

Una prueba rápida para la detección cualitativa de antígeno NS1, los anticuerpos IgG e IgM del virus del dengue en humanos de sangre entera, suero o plasma. Para uso profesional de diagnóstico in vitro

【USO】

El Casete Combo de Prueba Rápida para Dengue (Sangre entera/Suero/Plasma) es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa del antígeno NS1 y los anticuerpos IgG e IgM del virus del dengue en sangre entera humana, suero o plasma como una ayuda en el diagnóstico de infecciones de dengue.

【RESUMEN】

El dengue es un flavivirus, transmitido por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Se encuentra ampliamente distribuido en todas las zonas tropicales y subtropicales del mundo,¹ y causa hasta 100 millones de infecciones de al año.² La infección se caracteriza por un inicio repentino de fiebre, cefalea intensa, mialgias, artralgias y exantema.

La infección primaria del dengue provoca anticuerpos IgM para aumentar a un nivel detectable en 3 a 5 días después del inicio de la fiebre. Los anticuerpos IgM generalmente persisten durante 30 a 90 días.³ La mayoría de los pacientes de dengue en las regiones endémicas tienen infecciones secundarias,⁴ lo que resulta en altos niveles de anticuerpos IgG específicos antes o a la par con la respuesta de los IgM.⁵ Por lo tanto, la detección de anticuerpos específicos Anti-Dengue IgM e IgG también pueden ayudar a distinguir entre las infecciones primarias y secundarias.

NS1 es una de las 7 proteínas no estructurales del virus del dengue que se cree que participan en la replicación viral. NS1 existe como un monómero en su forma inmadura, pero se procesa rápidamente en el retículo endoplásmico para formar un dímero estable. Una pequeña cantidad de NS1 permanece asociada a orgánulos intracelulares donde se cree que está involucrado en la replicación viral. El resto de NS1 se encuentra ya sea asociada con la membrana plasmática o secretada como hexámero soluble. NS1 es esencial para la viabilidad viral pero su función biológica precisa es desconocida. Los anticuerpos producidos en respuesta a NS1 en la infección viral puede reaccionar cruzados con antígenos de superficie celular sobre las células epiteliales y las plaquetas y esto ha sido implicados en el desarrollo de fiebre hemorrágica del dengue.

El Casete Combo de Prueba Rápida para Dengue es una prueba rápida que utiliza una combinación de partículas coloreadas recubiertas de antígeno de Dengue para la detección del antígeno NS1 del dengue, anticuerpos IgG e IgM contra el dengue en sangre entera humana, suero o plasma.

【PRINCIPIO】

El Casete de Prueba Rápida para Dengue IgG/IgM es un inmunoensayo cualitativo basado en membrana para la detección de anticuerpos de dengue en sangre entera, suero o plasma. Esta prueba consiste en dos componentes, un componente de IgG y un componente de IgM. En el componente de IgG, el IgG anti-humano está revestido en zona de la prueba de IgG. Durante la prueba, la muestra reacciona con las partículas antígeno de dengue recubiertas en el área de prueba. La mezcla luego migra hacia arriba en la membrana cromatográficamente por acción capilar y reacciona con el anti-IgG humana en la región de línea de prueba IgG. Si la muestra contiene anticuerpos IgG contra el dengue, una línea de color aparecerá en la zona de la prueba de IgG. En el componente de IgM, anti-IgM humana está recubierto de zona de la prueba de IgM. Durante la prueba, la muestra reacciona con IgM anti-humano. anticuerpos del dengue IgM, si está presente en la muestra, reacciona con la IgM anti-humano y las partículas recubiertas de antígeno de dengue en el casete de prueba, y este complejo es capturado por la IgM anti-humano, formando una línea de color en la zona de la prueba de IgM .

Por lo tanto, si la muestra contiene anticuerpos IgG dengue, una línea de color aparecerá en la zona de la prueba de IgG. Si la muestra contiene anticuerpos IgM dengue, una línea de color aparecerá en la zona de la prueba de IgM. Si la muestra no contiene anticuerpos del dengue, hay una línea de color aparecerá en cualquiera de las regiones de línea de verificación, lo que indica un resultado negativo. Para servir como control del procedimiento, una línea coloreada aparecerá siempre en la zona de control, lo que indica que el volumen apropiado de muestra se ha añadido, y ha producido reacción de la membrana.

El Casete de Prueba Rápida para Dengue NS1 es un inmunoensayo basado en membrana cualitativo para la detección del antígeno de Dengue NS1 en sangre entera, suero o plasma. Durante la prueba, la muestra reacciona con Dengue-anticuerpo conjugado en el casete de prueba. El anticuerpo conjugado de oro se unirá al antígeno de dengue en la muestra de prueba que a su vez se unirá con Anti-Dengue NS1

recubierto por la membrana. A medida que los reactivos se mueven a través de la membrana, el anticuerpo Dengue NS1 en la membrana se unirá el complejo antígeno-anticuerpo causando línea rosa pálido u oscuro para formar en la zona de la prueba de la membrana de prueba. La intensidad de las líneas variará dependiendo de la cantidad de antígeno presente en la muestra. La aparición de la línea de color rosa en la región de la prueba debe considerarse como resultado positivo.

【REACTIVOS】

El Casete de Prueba Rápida para Dengue IgG/IgM antígeno del dengue conjugado con partículas coloidales de oro, anti-humano IgM, IgG anti-humano cubierto en la membrana.

El Casete de Prueba Rápida para Dengue NS1 contiene partículas coloidales anti-dengue conjugado con Ag, Ag anti-dengue cubierto en la membrana.

【PRECAUCIONES】

- Solo para uso profesional en diagnóstico in vitro. No usar después de la fecha de vencimiento.
- No ingiera alimentos, bebidas ni fume en el área donde se manipulan las muestras o kits.
- Manipule las muestras como si contienen agentes infecciosos. Mantenga precauciones contra amenazas microbiológicas durante todos los procesos y siga los procedimientos normativos para desechar las muestras adecuadamente. Use prendas de protección como batas de laboratorio, guantes desechables y lentes para el ensayo con muestras.
- Use vestimenta de protección con batas de laboratorio, guantes desechables e lentes.
- La humedad y la temperatura pueden afectar los resultados negativamente.

【ALMACENAMIENTO】

Almacene el producto en su empaque sellado a temperatura ambiente o refrigerado (entre 2 y 30°C) hasta la fecha de vencimiento indicada en el empaque. La prueba deberá permanecer en el empaque sellado hasta que sea usada. **NO CONGELAR.** No usar después de la fecha de expiración.

【RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA Y PREPARACIÓN】

- El Casete de Prueba Rápida para Dengue puede usar sangre pura (por venopunción o punción en el dedo), suero o plasma.
- Para recolectar muestras de **Sangre Pura por Punción en el Dedo**: Lave la mano del paciente con jabón y agua tibia o límpiela con algodón y alcohol. Deje secar. Masajea la mano sin tocar el lugar de la punción, frotando hacia la punta del dedo medio o anular. Pinche la piel con una lanceta estéril. Limpie la primera aparición de sangre. Frote la mano gentilmente desde la muñeca hacia la palma y luego el dedo para formar una gota redonda de sangre sobre el lugar de la punción.

- Separe el suero o el plasma de la sangre en la brevedad posible para evitar hemólisis. Utilice sólo muestras no hemolizadas.
- La prueba debe completarse inmediatamente después de haber recolectado las muestras. No deje muestras a temperatura ambiente por períodos prolongados. Las muestras de suero o plasma pueden ser almacenadas a temperaturas entre 2°C y 8°C hasta por 3 días. Para almacenamiento a largo plazo, las muestras deben mantenerse a temperaturas por debajo de los -20°C. La sangre pura recolectada por venopunción debe ser almacenada a temperaturas entre 2-8°C si la prueba se completará en los próximos 2 días. No congele muestras de sangre pura. La sangre pura recolectada por punción del dedo deberá ser puesta a prueba inmediatamente.
- Lleve las muestras a temperatura ambiente antes de hacer la prueba. Las muestras congeladas deben estar completamente descongeladas y bien mezcladas antes de hacer la prueba. Las muestras no deben ser congeladas y descongeladas repetidas veces.
- Si las muestras han de ser transportadas, deberán ser empacadas siguiendo las regulaciones que cubren el transporte de agentes etiológicos.
- EDTA K2, heparina de sodio, citrato de sodio y oxalato de potasio se pueden usar como anticoagulantes para la recolección de la muestra.

【MATERIALES】

Materiales Incluidos

- Prueba en casete
- Buffer
- Ficha Técnica
- Gotero de 5 µL para prueba IgG/IgM
- Gotero de 25 µL para prueba NS1

Materiales requeridos no incluidos

- Envases de colección de espécimen
- Centrifuge
- Temporizador
- Lancetas (para punción de dedo)
- Micropipeta

【INSTRUCCIONES DE USO】

Permita que la prueba, la muestra y el Buffer lleguen a temperatura ambiente (15-30°C) antes de comenzar el proceso.

1. Lleve el empaque a temperatura ambiente antes de abrirlo. Remueva el casete del empaque sellado y úselo dentro de la próxima hora.

2. Coloque el casete en un área limpia y estable.

- Para muestras de **Suero o Plasma**:

Para IgG/IgM:

- **Para utilizar un gotero:** Sostenga el gotero verticalmente, llene con muestra hasta la línea de llenado (aproximadamente 5 µl), y transfiera la muestra al pocillo de muestras(S) del casete de prueba, a continuación, añadir **3 gotas de Buffer** (aproximadamente 120µl) al pocillo de buffer(B) e iniciar el temporizador. Evitar que queden atrapadas burbujas de aire en el pocillo de muestra.
- **Para utilizar una micropipeta:** Llene la pipeta y dispense **5 µl de suero o plasma** al pozo de muestras(S) del casete de prueba, a continuación, añadir **3 gotas de Buffer** (aproximadamente 120 µL) al pocillo de buffer(B) y iniciar el temporizador.

Para NS1:

- Coloque el gotero en posición vertical, añadir **3 gotas de suero o plasma** (aproximadamente 75µl) al pocillo la muestra(S), e iniciar el temporizador. Consulte la imagen siguiente.

- Para muestras de **Sangre entera (venopunción o punción dactilar)**:


Para IgG/IgM:

- Para usar un gotero: Sostenga el gotero verticalmente, llene con muestra hasta 1 cm por encima de la línea de llenado, y transfiera de **1 gota de sangre entera** (aproximadamente 10µl) al pocillo de muestras(S) del casetes de prueba. A continuación, añada **3 gotas de Buffer** (aproximadamente 120 µl) al pocillo del buffer e inicie el temporizador. Consulte la imagen siguiente.
- Para utilizar una micropipeta: Dispense **10 µl** de sangre entera al pocillo de muestras(S) del casete de prueba. A continuación, añada **3 gotas de Buffer** (aproximadamente 120 µl) al pocillo del buffer e inicie el temporizador. Consulte la imagen siguiente.

Para NS1:

- Para usar un gotero: Sostenga el gotero en posición vertical, añadir **3 gotas de sangre entera** (aproximadamente 75 µL) a la superficie de la muestra, a continuación, añadir **1 gota de Buffer** (aproximadamente 40 µL) e iniciar el temporizador. Consulte la imagen siguiente.
- Para utilizar un tubo capilar: Llenar el tubo capilar y transferir aproximadamente **75 µL de muestra de sangre** por punción capilar a la superficie de la muestra del casete de prueba, a continuación, añadir **1 gota de Buffer** (aproximadamente 40 µL) e iniciar el temporizador. Consulte la imagen siguiente.

3. **Lea los resultados a los 10 minutos**, no interprete los resultados después de 20 minutos.

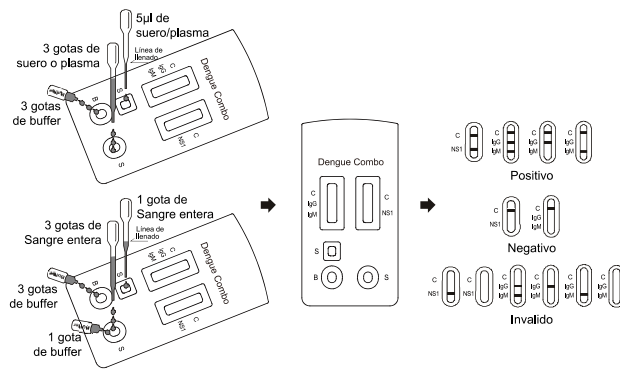

【INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS】

(Use la imagen de arriba como referencia)

NS1 POSITIVO: * Dos líneas de color aparecen. Una línea de color debe estar en la región de control (C) y otra línea de color debe estar en la región de prueba (T).

IgG y IgM POSITIVO: *Tres líneas aparecen. Una línea coloreada debe estar en la región de control (C), y dos líneas de color debe aparecer en zona de la prueba de IgG e IgM zona de la prueba. Las intensidades de color de las líneas no tienen que coincidir. El resultado es positivo para anticuerpos IgG y IgM y es indicativo del término de la etapa final de infección primaria de dengue y etapa temprana de infección secundaria de dengue.

IgG POSITIVO: *Aparecen dos líneas. Una línea coloreada debe estar en la región de control (C), y una línea de color aparece en la zona de la prueba de IgG. El resultado

es positivo para el virus Dengue-IgG específica y es probablemente indicativo de infección secundaria Dengue.

IgM POSITIVO: *parecen dos líneas. Una línea roja debe estar en la región de control (C), y una línea de color aparece en la zona de la prueba de IgM. El resultado es positivo para los anticuerpos IgM específicos del virus del dengue y es indicativo de infección primaria del dengue.

***NOTA:** La intensidad del color en la región de línea de prueba (NS1 y / o IgG y / o IgM) variará dependiendo de la concentración de antígeno de Dengue NS1 y / o IgG y / o IgG presente en la muestra. Por lo tanto, cualquier tono de color rojo en la región de la prueba debe ser considerado positivo.

NEGATIVO: Una línea de color aparece en la región de control (C). No aparece ninguna línea en la región de prueba (T).

INVALIDO: Si la línea del área de control (C) no aparece. Las razones más comunes para el resultado invalido son tamaño de la muestra insuficiente o técnicas de procedimiento equivocadas. Revise el procedimiento e intente nuevamente la prueba con un Nuevo casete. Si el problema persiste, deje de usar el kit de prueba inmediatamente y contacte a su distribuidor local.

【CONTROL DE CALIDAD】

La prueba incluye controles internos de procedimiento. Una línea coloreada en la región control (C) refiere un control interno positivo del procedimiento. La línea confirma que se agregó un volumen suficiente de muestra y que el procedimiento se realizó de manera correcta.

Este kit no incluye estándares de control; sin embargo, se recomienda utilizar controles positivo y negativo como buenas prácticas de laboratorio para confirmar el procedimiento y verificar el funcionamiento correcto de la prueba.

【LIMITACIONES】

- El Casete de Prueba Rápida para Dengue (Sangre entera/Suero/Plasma) sólo indicará la presencia del antígeno NS1 del dengue y anticuerpos de dengue en la muestra y no debe ser utilizado como el único criterio para el diagnóstico de dengue.
- El procedimiento de ensayo y el resultado de Interpretación del ensayo deben ser seguidos de cerca cuando se prueba la presencia del dengue Ag en suero o plasma de sujetos individuales. Si no sigue el procedimiento puede dar resultados inexactos.
- Un resultado negativo de la prueba de Dengue NS1 no excluye la posibilidad de exposición a la infección crónica por el virus del dengue.
- Un resultado negativo para el Dengue NS1 puede ocurrir si la cantidad de antígeno de dengue presente en la muestra está por debajo de los límites de detección del ensayo, o el antígeno de dengue que se detectan no están presentes durante la etapa de la enfermedad en la que se recoge una muestra.
- Algunas muestras que contienen una concentración inusualmente alta de anticuerpos heterófilos o el factor reumatoide pueden afectar los resultados esperados.
- Si el síntoma persiste, mientras que el resultado del Dengue NS1 prueba rápida es negativo o un resultado no reactivo, se recomienda volver a muestrear los pacientes unos días de retraso o la prueba con un casete de prueba alternativo tal como PCR, ELISA.
- Los resultados obtenidos con esta prueba sólo deben interpretarse en conjunción con otros procedimientos de diagnóstico y hallazgos clínicos.
- En la etapa temprana de la fiebre, las concentraciones de anti-Dengue IgM pueden estar por debajo de los niveles detectables. Para la infección primaria, un anticuerpo de captura de ensayo de sorbente inmune ligado a enzimas IgM (MACELISA) mostró que 80% de los pacientes con dengue ensayados exhibió niveles detectables de anticuerpos IgM al quinto día después de la infección, y 99% de los pacientes a prueba IgM positivo al día 10. Se recomienda que los pacientes se hagan la prueba dentro de este tiempo. Para la infección secundaria, una fracción molar baja de anti-Dengue IgM y una fracción molar alta de IgG que es ampliamente reactivos a flavivirus caracterizan los anticuerpos.⁵ La señal de IgM puede ser leve y puede aparecer la reacción cruzada en la región de la línea de IgG.
- La reactividad serológica cruzada en todo el grupo de flavivirus (dengue 1, 2, 3 y 4, encefalitis de San Luis, el virus del Nilo Occidental, la encefalitis japonesa y el virus de la fiebre amarilla) es común.^{6,7,8} Los resultados positivos deben ser confirmados por otros medios.
- La continua presencia o ausencia de anticuerpos no pueden ser utilizados para determinar el éxito o el fracaso de la terapia.
- Resultados de pacientes inmunodeprimidos deben ser interpretados con precaución.
- Como con todas las pruebas de diagnóstico, todos los resultados deben interpretarse junto con otra información clínica disponible al médico.
- Si el resultado de la prueba es negativo y los síntomas clínicos persisten, se recomienda realizar pruebas adicionales utilizando otros métodos clínicos. Un resultado negativo no excluye en ningún momento la posibilidad de infección por dengue.

【VALORES ESPERADOS】

La Prueba Rápida para Dengue NS1 (Sangre entera/Suero/Plasma) ha sido comparado con una prueba comercial líder del dengue ELISA Ag. La correlación entre estos dos sistemas es 96,0%.

La infección primaria Dengue se caracteriza por la presencia de anticuerpos detectables de IgM 3-5 días después de la aparición de la infección. La infección secundaria Dengue se caracteriza por la elevación de Dengue-IgG específica. En la mayoría de los casos, esto va acompañado de niveles elevados de IgM.

La prueba rápida de Dengue (Sangre entera/Suero/Plasma)) ha sido comparado con una prueba comercial líder Dengue ELISA, demostrando la sensibilidad de 83,3% para IgM en la infección primaria y 98.4% para IgG en infección secundaria.

【CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO】

Sensibilidad y Especificidad

El Casete de Prueba Rápida para Dengue (Sangre entera/Suero/Plasma) ha aprobado por un panel de seroconversión comparándolo con una prueba líder comercial dengue ELISA usando muestras clínicas para Dengue NS1 y ha sido evaluado con muestras obtenidas de una población de individuos sintomáticos y asintomáticos. Los resultados se confirmaron mediante un ensayo de la marca comercial líder ELISA de Dengue para IgG y IgM.

Los resultados muestran que la sensibilidad relativa del Casete de Prueba Rápida para Dengue NS1 (Sangre entera/Suero/Plasma) es del 95,8%, y la especificidad relativa es del 96,1%. La sensibilidad relativa global de la infección primaria y secundaria de la prueba rápida del Casete de Prueba Rápida para Dengue (Sangre entera/Suero/Plasma) es del 94.3%, y la especificidad relativa es 99.1%, y la precisión relativa es del 98.3%.

Dengue IgG/IgM

Dengue Infección Primaria, los resultados de la prueba IgM / IgG				
Método		ELISA		
Dengue Prueba Rápida de Casete (Sangre entera/Suero/Plasma))	Resultados	Positivo		Negativo
		IgM	IgG	
	Positivo	IgM	20	0
		IgG	4	0
	Negativo		0	0
			83.3%	/

Dengue Infección Secundaria, resultados de la prueba de IgM / IgG				
Método		ELISA		
Dengue Prueba Rápida de Casete (Sangre entera/Suero/Plasma))	Resultados	Positivo		Negativo
		IgM	IgG	
	Positivo	IgM	46	1
		IgG	18	63
	Negativo		0	0
			0	0

No Dengue Infección, resultados de la prueba de IgM / IgG				
Método		ELISA		
Dengue Prueba Rápida de Casete (Sangre entera/Suero/Plasma))	Resultados	Positivo		Negativo
		IgM	IgG	
	Positivo	IgM	0	0
		IgG	0	0
	Negativo		0	0
			0	0

Sensibilidad Relativa: (20+63)/ (24+64) =94.3% (95%CI*: 87.2%–98.1%);
Especificidad Relativa: 429/433=99.1% (95%CI*: 97.7%–99.7%);
Precisión: (20+63+429)/ (24+64+433) =98.3% (95%CI*: 96.7%–99.2%).
* Intervalo de confianza

Dengue NS1

Método		EIA		Resultado Total
Casete de Prueba Rápida para Dengue NS1	Resultados	Positivo	Negativo	
	Positivo	137	8	145
	Negativo	6	200	206
Resultado Total		143	208	351

Sensibilidad relativa: 137/143*100%=95.8% (95%CI*: 91.1%–98.4%);
Especificidad relativa: 200/208*100%=96.1% (95%CI*: 92.6%–98.4%);
Precisión: (137+208)/(137+6+8+200)*100%=96.0%(95%CI*:93.4%–97.8%)
* Intervalos de confianza

Precisión Intra-ensayo

La precisión en una misma serie se determinó utilizando 15 réplicas con muestras de dengue. Las muestras fueron identificadas correctamente > 99% de las veces.

Inter-ensayo

Precisión entre distintas series ha sido determinado por 15 ensayos independientes en las mismas muestras de dengue. Tres lotes diferentes del Casete Combo de Prueba Rápida para Dengue se han probado usando estas muestras. Las muestras se identificaron correctamente> 99% de las veces.

Reacciones Cruzadas

El Casete de Prueba Rápida para Dengue ha sido probado con muestras positivas para HAMA, RF, HBSAg, HBSAb, HBsAg, HBsAb, HBcAb, anti-sifilis, anti-VIH, HCV, anti-H. Pylori, anti-MONO, anti-CMV, anti-rubéola y anti-TOXO. Los resultados mostraron ausencia de reactividad cruzada.

Substancias que Interfieren

Las siguientes sustancias potencialmente interferentes se añadieron a muestras negativas y positivas de Dengue.

Acetaminofén: 20 mg/dL	Ácido Acetilsalísílico: 20 mg/dL	Ácido Ascórbico: 2g/dL
Bilirubina: 1g/dL	Creatina: 200 mg/dL	Cafeína: 20 mg/dL
IgG Gentísico: 20 mg/dL	Hemoglobina: 1000mg/dL	Albúmina: 2 g/dL
Ácido Oxálico: 60mg/dL		

Ninguna de las sustancias con las cantidades mencionadas interfirieron con la prueba.

【BIBLIOGRAFÍA】

- Halstead SB, Selective primary health care: strategies for control of disease in the developing world: XI, Dengue. Rev. Infect. Dis. 1984; 6:251-264.
- Halstead SB, Pathogenesis of dengue: challenges to molecular biology. Science 1988; 239:476-481.
- Ruechusatsawat K, et al. Daily observation of antibody levels among dengue patientsdetected by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). *Japanese J. Trop. Med.Hygiene* 1994; 22: 9-12
- Lam SK. Dengue haemorrhagic fever. *Rev. Med. Micro.* 1995; 6:39-48
- Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment, prevention and control. 2nd edition.Geneva: World Health Organization
- Yamada K, et al. Antibody responses determined for Japanese dengue fever patients by neutralization and hemagglutination inhibition assays demonstrate cross-reactivity between dengue and Japanese encephalitis viruses. Clin Diagn Lab Immunol. 2003 Jul; 10(4): 725-8.
- Dobler G, et al. Cross reactions of patients with acute dengue fever to tick-borne encephalitis. Wien Med Wochenschr (in German). 1997; 147(19-20): 463-4
- Makino Y, et al. Studies on serological cross-reaction in sequential flavivirus Microbiol Immunol. 1994; 38(12): 951-5.



Consulte las instrucciones de uso



Sólo para uso de diagnóstico in vitro



Almacenar a 2-30 ° C



No usar si el envase está dañado



Pruebas por kit



Usar hasta



Numero de Lote



Fabricante



Representante Autorizado



No reutilizar



de Catálogo



MedNet GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster
Germany



Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550, Yinhai Street
Hangzhou Economic & Technological Development Area
Hangzhou, 310018 P.R. China
Web: www.alltests.com,cn Email: info@alltests.com,cn

Distribuido por DIAGNOSE S.A. DE C.V.
Circunvalación Ote. 140-A
Ciudad Satélite, Naucalpan
Estado de México, C.P.53100
Tel. (55) 8942 7900

Numero: 146258704
Última Revisión: 2021-